

Model K9000-M (P)

(pH/ORP/Ion//Temp)

pH/ORP/Ion Meter
Instruction Manual



iSTEK (주) 이 스텝

Homepage : www.istek.co.co.kr

E-mail : istek@istek.co.co.kr

Table of Contents

제 1 장	Introduction	4
제 2 장	General Functions	
	1. K9000-M(P) 구성	5
	(1) 기본 구성품 및 기능	5
	(2) 추가 구성품	5
	2. 커넥터 및 연결	6
	3. 키패드 설명	7
	4. 화면 구성	8
	5. 전극 설명	9
	(1) pH/ORP Electrode	9
	- 보관	9
	- 유지보수	9
	(2) Ion Electrode	10
	- 보관	10
	- 유지보수	10
제 3 장	Setup Construction	
	1. 기기 Setup	11
	2. pH/ORP/Ion Setup	11
	3. Display Setup	12
제 4 장	Calibration	
	1. pH	13
	(1) Auto (자동보정)	13
	(2) Manual (수동보정)	16
	2. ORP	18
	(1) 228mV 의 보정	18
	(2) 475mV 의 보정	19
	3. Ion	20
제 5 장	Data-Log	21
	1. Mode	21
	2. Auto Save	22
	3. Interval	22

제 6 장	Save Data & Transfer	23
	1. Manual Save Data	23
	2. Auto Save Data Transfer	23
	3. Real-Time Data Transfer	26
제 7 장	Memory Clear	28
	1. Memory Clear	28
	2. All Clear	29
제 8 장	Troubleshooting & Error Description	30
제 9 장	Specification & Ordering Information	31
	1. Specification	31
	2. Ordering Information	32
	3. 순서도	34

제 1 장 Introduction

(주)이스텍의 NeoMet K9000-M(P)제품은 AC/DC Adaptor (DC 12V)로 작동되며 계측에 필요한 모든 동작이 Micro-processor 에 의해 조절되며, pH/ORP/Ion/Temp. 항목의 측정이 가능한 pH/ORP/Ion 측정기기이다. TFT 4.3 인치 컬러 LCD 의 넓은 화면과 데이터 인쇄용 프린터를 외장(옵션)하여 연구실험실에서의 사용에 있어 성능과 기능을 향상시켰으며 사용자의 입장에 선 화면 구성으로 조작이 간단한 특징을 지닌다. 데이터를 기기에 최대 100,000 개 까지(자동 100,000 개/수동 500 개) 저장할 수 있으며 RS-232C 통신 출력에 의해 데이터를 최소 1 초 간격(사용자 설정)으로 실시간 PC 전송(무한대) 받을 수 있다.

■ K9000-M(P) (pH/ORP/Ion/TEMP Meter)

Desktop K9000-M(P) Meter 는 단일 채널 제품으로 pH/ORP/Ion 중 원하는 측정항목을 측정할 수 있다. 온도는 센서 연결시 기본으로 측정되며 타입별로 선택하여 사용이 가능하다.

- 온도타입 선택 : PT100 / PT1000

■ pH/ORP/Ion

pH : 수소(H^+) 이온 농도의 세기를 나타냄 ($pH = -\log_{10}(\text{수소이온농도})$ 로 표현)

- 보정 point : 최소 2 point, 최대 5 point 까지 가능
- 보정 타입 : 자동(Auto)/수동(Manual)

ORP : Oxydation Reduction Potential 의 약어로 산화환원 전위차이며 이온의 활동도를 나타냄

- 보정 point : 1 point 로 228mV 와 475mV 중 택 1
- 측정 타입 : 절대 ORP/상대 ORP
(절대 ORP(Absolute mV)) : 실제로 읽어 들이는 기전력의 크기
(상대 ORP(Relative mV)) : 상대적인 기전력의 크기

Ion : 물속에 존재하는 이온의 농도를 mg/l 또는 ppm 단위로 나타냄

- 이온의 종류에 따라 각각의 이온에만 선택적으로 감응하는 전극을 사용
- 보정 point : 최소 2 point, 최대 5 point 까지 가능

제 2 장 General Functions

1. K9000-M(P)의 구성

(1) 기본 구성품 및 기능

(주)이스텍의 K9000-M(P)는 제공된 AC/DC 아답터로 작동 되며, 기본 구성품은 다음과 같다.

K9000-M(P)본체, 기본 구성품, AC/DC 아답터, Luxury Third-arm Stand, PC 연결 Software (SMSD), 데이터 전송 cable, 사용자설명서 및 품질보증서

* 기본 구성품


- pH : pH Electrode, ATC probe, Buffer pH 4,7,10 set (125ml), pH Storage Solution (125ml)
- ORP : ORP Electrode, ATC probe, ORP Standard Solution 125ml (228mV 또는 475mV 중 택 1), ORP Storage Solution (125ml)
- Ion : Ion Electrode, ATC probe, Ion Standard Solution 100/1000 ppm (475ml), Ion Filling Solution (125ml), Ion ISA (Ion Selective Adjustor) Solution 125ml, Ion 전극 매뉴얼

* Ion 의 종류에 따라 제공되는 항목 및 용량에 변경이 있을 수 있음

(2) 추가 구성품


- Thermal Printer (외장형 프린터)
- Buffer pH 4,7,10 set (475ml)
- Storage Solution (475ml) - pH/ORP
- ORP Standard Solution (475ml)
- RS-232C to USB 통신 cable

2. 커넥터 및 연결

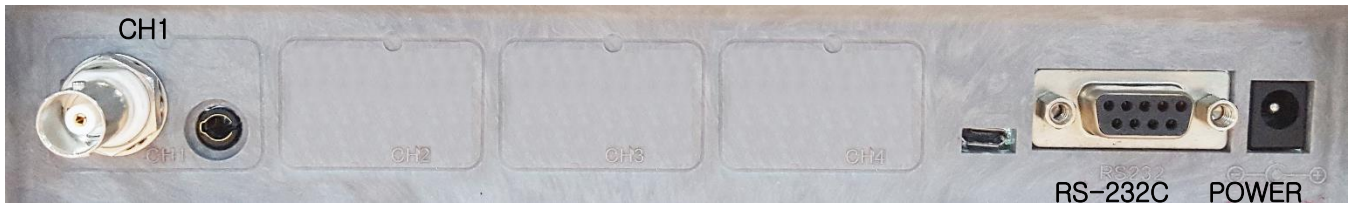


- pH/ORP/Ion : BNC / PJ362(3.5mm 폰 잭)
- RS-232C 커넥터 : 기기와 PC 를 RS-232C Interface Cable 로 연결하여 데이터를 실시간 출력
- Power : 12V 2.5A 아답터 연결

3. 키패드 설명

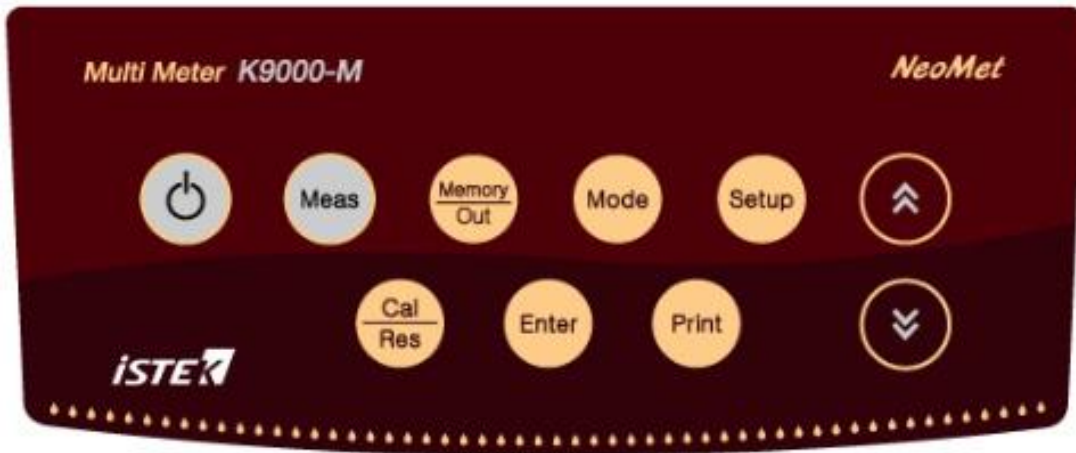


Key	Description
Power	전원 ON/OFF 에 사용
Meas	Measure(측정)상태와 Ready(대기)상태 전환
Memory/Out	- Measure 상태 : Data 를 기기 내부에 저장 - Ready 상태 : 저장된 Data 확인 - 보통 : 전 단계로 이동 및 진행 취소
Mode	단일 채널에 대한 항목 변경
Setup	- 각 항목에 대한 기능 설정 및 변경 - 기기 전체에 대한 기능 설정 및 변경 - ORP 항목 : 절대 ORP 와 상대 ORP 전환
Cal/Res	- Ready 상태 : 선택된 항목에 대해 보정 시작 및 보정 값 저장 - Measure 상태 : 측정값의 분해능 변환시 사용 (0.001/0.01/0.1)
Enter	- 해당 메뉴 선택 - pH 항목 : Slope 확인
Print	저장된 Data 인쇄
Up/Down arrow	- 전체화면(다채널) 및 모듈(1 채널) 변경 - 메뉴 이동

4. 화면 구성

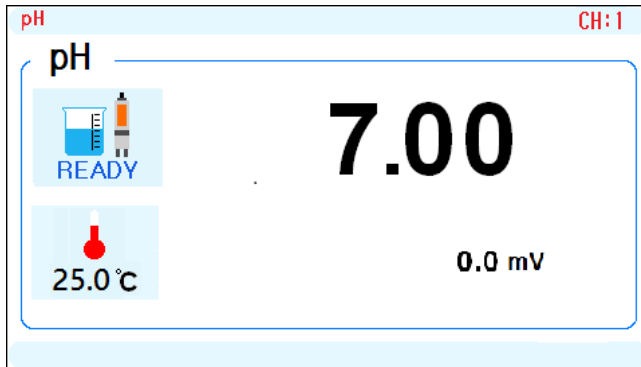


단항목 측정시 화면

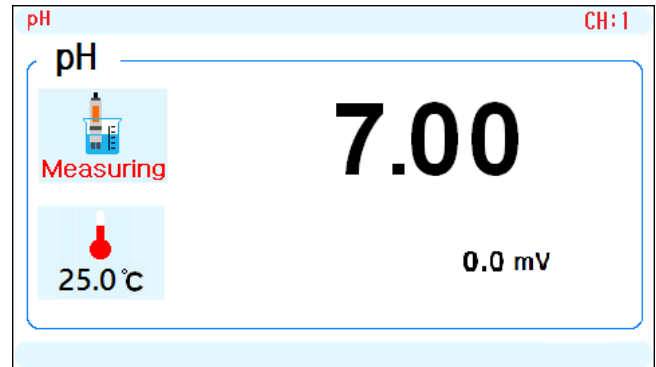


단항목 대기시 화면

화면 설명

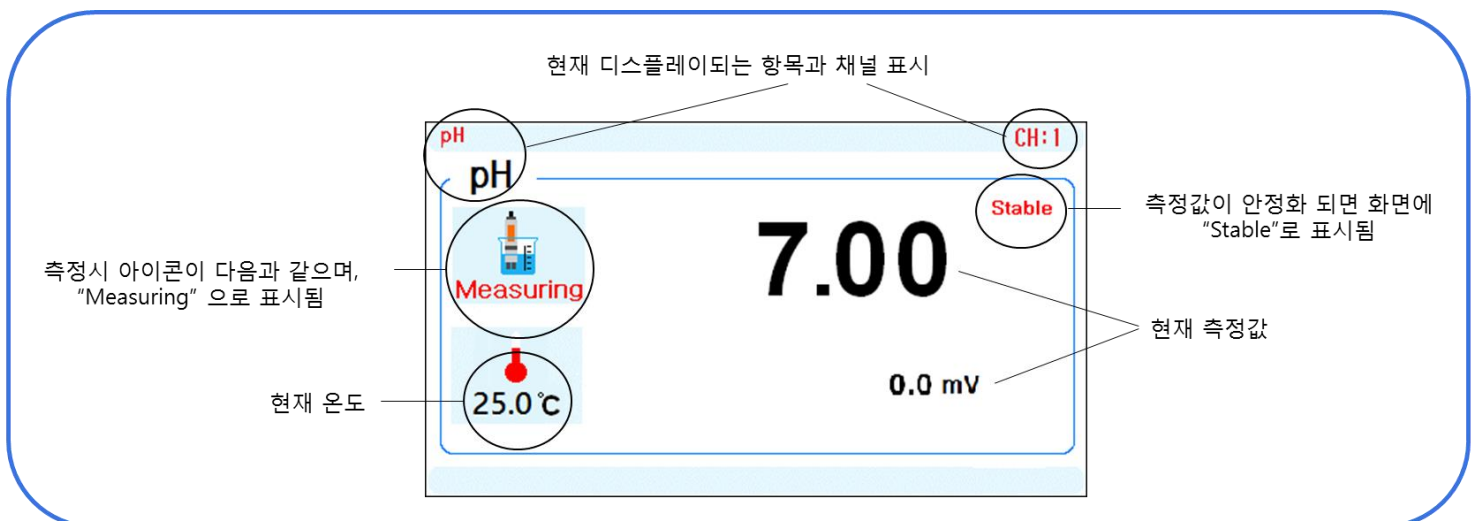

**




측정 대기시 아이콘이 다음과 같으며, "READY" 로 표시됨

5. 전극 설명

(1) pH/ORP Electrode

pH 전극 구조

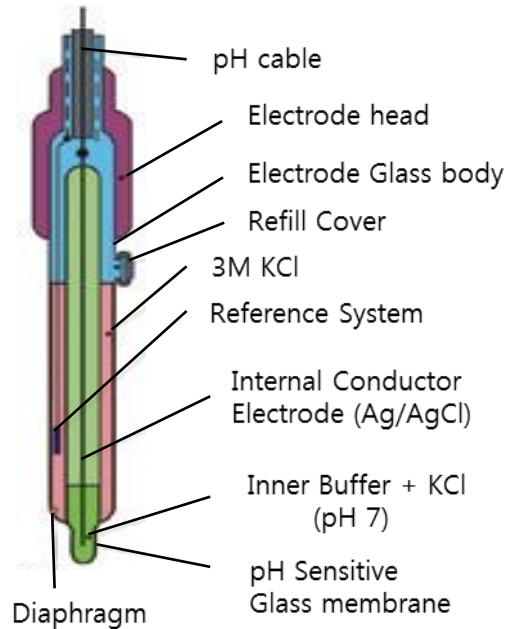

1-1) Storage (보관)

pH 와 ORP 전극은 이스텍에서 제공하는 Cap Storage Solution 을 사용하여 Membrane 이 항상 젖은 상태로 보관한다.

전극은 이스텍에서 제공하는 Electrode Storage Solution(KCl 과 pH 4.00 Buffer 성분 포함)으로 보관하며, 용액이 없을 경우 임시로 깨끗한 pH 4.00 Buffer 용액에 보관한다.

일반적으로 증류수에 전극을 보관하는 경우가 많은데, 증류수에 보관할 경우 전극의 수명을 단축시키는 원인이 된다.

- # R001250 Storage solution 125ml
- # R001000 Storage solution 475ml

1-2) Maintenance (유지보수)

-Electrode Cleaning-

- * 전극의 응답시간이 느리거나 안정된 Data 를 측정하지 못할 경우 다음과 같은 방법을 사용하여 전극을 정상적으로 회복시킨다.
- * 아래의 방법으로 전극의 문제점이 해결되지 않을 경우에는 새로운 전극을 구입해야 한다.

1. Salt 성분의 제거

- ① 0.1M HCl 과 0.1M NaOH 를 준비한다.

- ② 0.1M HCl 용액에 약 5 분간 전극을 넣어둔다.
- ③ 0.1M NaOH 용액에 약 5 분간 전극을 넣어둔다.
- ④ 위의 2 와 3 과정을 3 번 반복한다.

증류수로 전극을 깨끗이 세척한다.

2. Oil/Grease 막의 제거

합성세제 또는 일반적인 세제를 사용하여 Oil/Grease 막을 제거한 후 증류수로 세척한다.

3. Clogged Reference Junction(지시전극의 미세한 구멍이 막혀 있을 경우)

희석시킨 KCl 용액을 60~80℃ 정도로 가열한다. 여기에 전극을 10 분 정도 넣어 둔다.

전극을 가열하지 않은 KCl 용액에서 냉각한다.

4. 단백질의 제거

단백질 분해효소인 10%의 펩신에 0.1M 의 HCl 을 첨가하여 pH 1-2 로 맞춘 후 전극을 약 5 분 정도 넣어두고 난 후 증류수로 전극을 세척한다.

(2) Ion Electrode

2-1) Storage (보관)

Ion 종류의 특성상 각기 다른 보관용액에 보관한다.

단기간 보관시 : 전극 보관용액에 보관

장기간 보관시 : 전극내의 Filling Solution 을 제거하고, 외부 및 내부를 증류수로 깨끗이 세척한 후 전극 보호뚜껑으로 닫은 후 전극 케이스에 보관


2-3) Maintenance (유지보수)

-Electrode Cleaning-

* 전극의 멤브레인은 미세먼지로 인하여 오염 될 수 있으므로 장기간 사용 후, 반응이 느린 경우 Polishing Strip 페이퍼를 이용하여 표면을 매끄럽게 정리합니다.

제 3 장 Setup Construction

1. 기기 Setup

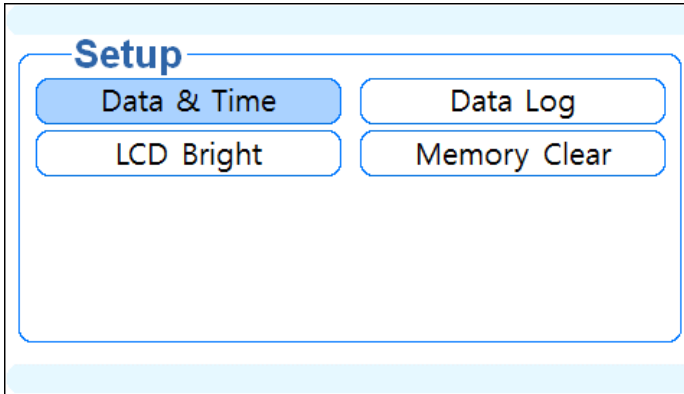

기기 전체에 대한 setup 을 진행한다.


단채널 화면 -> Setup -> Setup

[기기 Setup 화면]

설정 가능한 항목은 아래와 같다.

- 1) Data & Time : 날짜/시간 설정
- 2) LCD Bright : 화면 밝기 조정
- 3) Data Log : Mode - 데이터 전송 방법 설정(PC/Memory/Printer)
Auto-Save - 데이터 자동저장 설정
Interval - 데이터 출력 간격 설정(초단위)
- 4) Memory Clear : Memory - 저장된 데이터 삭제
ALL - 모든 데이터 삭제 (날짜/시간 제외)

2. pH/ORP/Ion Setup

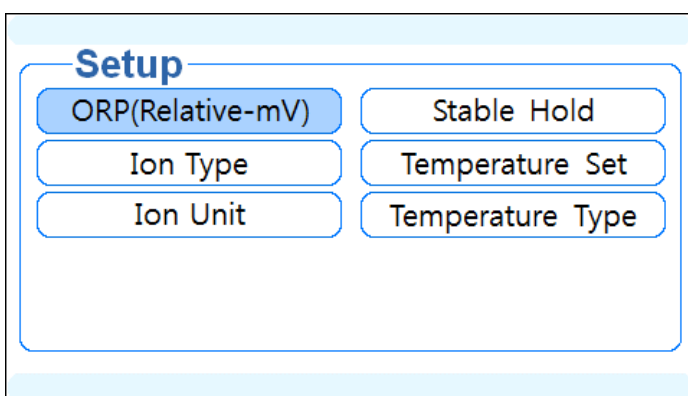

pH/ORP/Ion 항목에 대한 Setup 을 진행한다.

pH 단항목 화면 -> Setup

[pH/ORP/Ion 항목 Setup 화면]

설정 가능한 항목은 아래와 같다.

- 1) ORP(Relative-mV) : 상대 ORP 값 ON/OFF 설정
- 2) Ion Type : 이온 종류 선택 (22 개 Ion 종류 중 택 1)

- 3) Ion Unit : 이온 단위 설정 (mg/L, ppm)
- 4) Stable Hold : 측정 중 안정화된 데이터로 고정 (ON/OFF 설정)
- 5) Temperature Setup : 온도 보정 설정
- 6) Temperature Type : 온도 타입 설정 (PT100/PT1000)

3. Display Setup

Mode 키를 이용하여 측정항목 변경이 가능하다.


pH 화면 -> Mode -> 측정항목 변경

제 4 장 Calibration

단일 화면의 Ready 상태에서 Cal/Res 을 누르면 각 항목에 대한 보정화면으로 전환된다.

- <준비작업>
- 전원 공급을 확인한다. 모든 보정에 앞서 온도가 맞는지 확인한다.
 - 보정에 필요한 용액 및 세척액(증류수)를 준비한다.

1. pH

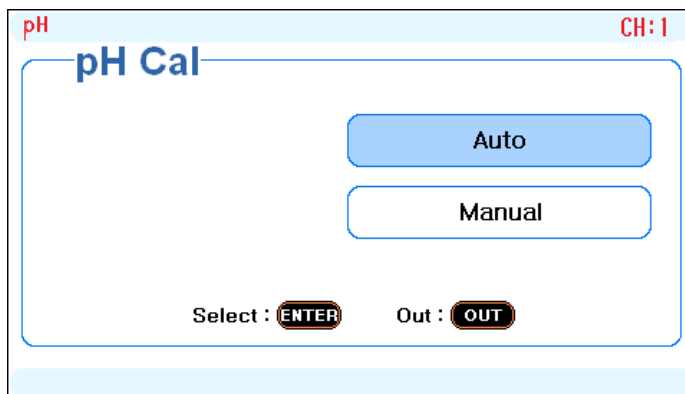

다음과 같은 순서로 보정 모드로 전환한다.

pH 화면 -> Cal/Res -> 보정화면

[pH 보정 초기 화면]

pH 보정은 2 가지 모드 중 하나를 선택하여 진행할 수 있다. Enter 키를 눌러 선택한다.

1. Auto(자동보정) : 최소 2 point / 최대 5 point 로 보정
정해진 보정 용액을 이용한 자동인식 보정
(pH 2.00 / pH 4.00 / pH 7.00 / pH 10.00 / pH 12.00)

2. Manual(수동보정) : 최소 2 point / 최대 5 point 로 보정
임의의 용액을 이용한 보정

* 주의 : 1point 보정은 안되며, 최소 2point 로 진행한다.

(주)이스텍 기기는 온도별 Buffer 농도를 자동보상 한다.


(1) Auto(자동보정)

1-1) Cal 1 의 보정




- 별도의 키 동작 없이 보정을 시작하면 자동으로 Measuring 상태가 된다.

- Probe 을 증류수로 세척하고 물기를 제거한 후 첫 번째 보정용액을 준비하여 전극을 담근다.

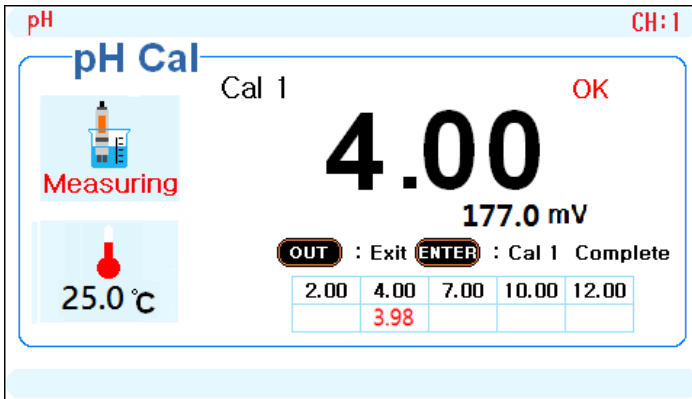

- 실측 값을 확인하며, 디스플레이 화면에 “Stable” 이 확인이 되면 **Enter** 키를 눌러 Cal 1 보정을 저장한다.
- 실측 값이 하단에 표시되며 Cal 1 보정이 완료된다. 그리고 자동으로 Cal 2 로 넘어간다.

별도의 키동작 없이 보정을 시작하면 자동으로 Measuring 상태가 된다.

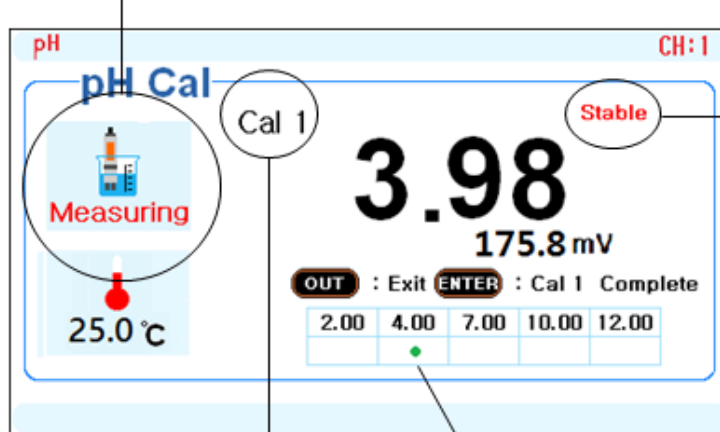


측정값이 안정이 되면 “Stable” 이라는 문구가 표시된다.


“●”은 현재 측정값을 인식하여 그 값에 맞는 보정값의 위치를 알려준다.

첫번째 보정임을 알려준다.

1-2) Cal 2 의 보정

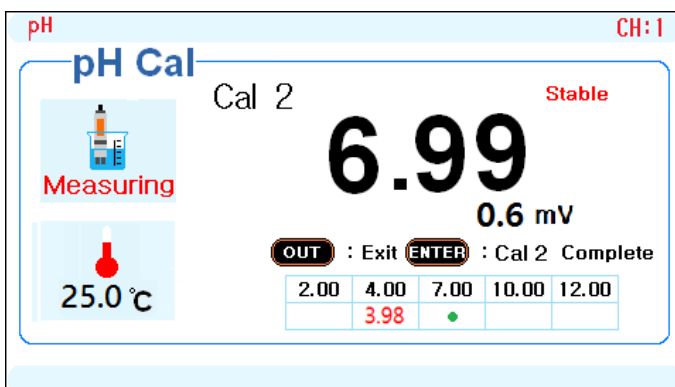


- Cal 1 이 완료 된 후, 화면이 바로 Cal 2 로 넘어간다.
- 전극을 증류수로 세척 후 두 번째 보정용액에 전극을 담근다.
- 실측 값이 안정되면 **Enter** 키를 눌러 Cal 2 보정을 완료한다.

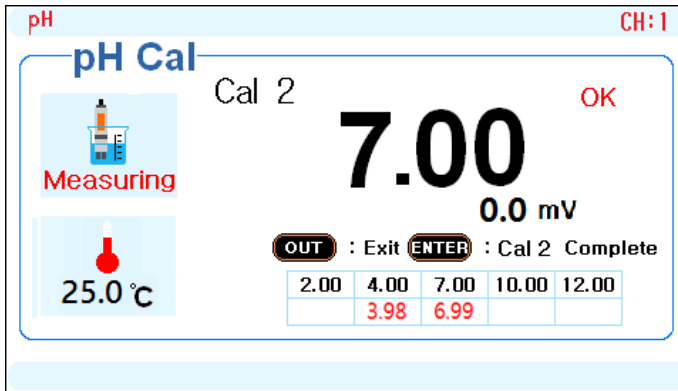


- Cal 2 보정 완료

1-3) Cal 3~5 의 보정

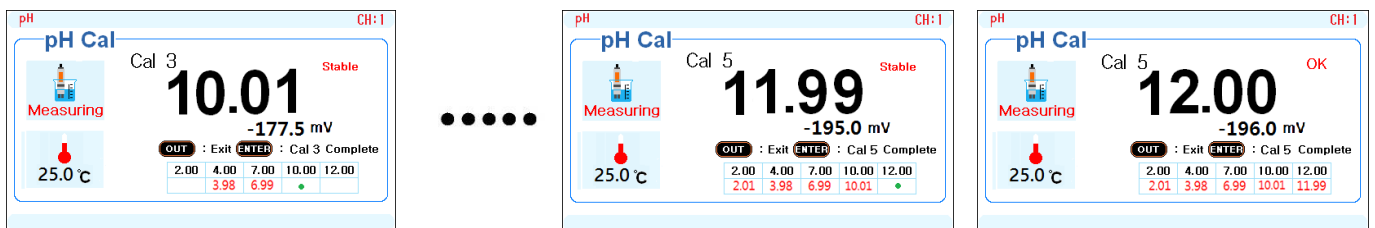

- Cal 3, Cal 4 그리고 Cal 5 의 보정 모두 동일한 방법으로 진행하며, 보정이 완료되면 Memory/Out 키로 마무리 한다.

1-4) 보정 중 메시지 화면

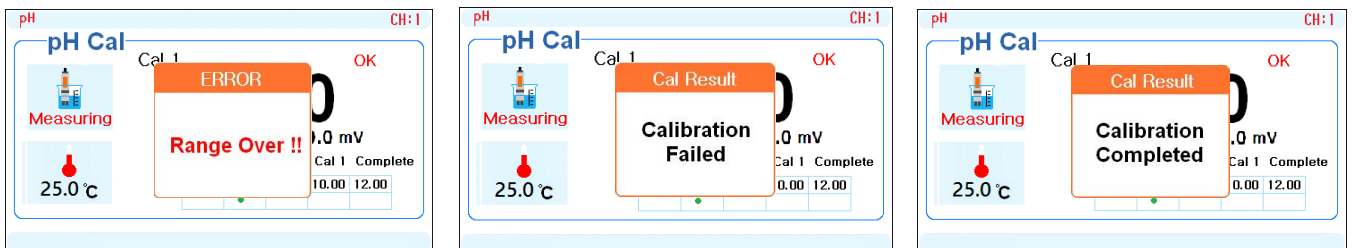


자동보정시 실측값이 기준 Buffer 의 ± 1 pH 이상 벗어난 경우, 보정 완료키 (ENTER)를 누르면 “Range Over !!” 범위초과 Error 화면이 1~2초 나타난 뒤 다시 보정 중 화면으로 돌아간다.

보정이 올바르게 되지 않았을 경우, “Calibration Failed” 보정실패 화면이 나타난다.
ex) 1 point로만 보정을 보고 마무리 Out키를 누른 경우.


보정이 최종 정상완료 되었을 경우, “Calibration Completed” 보정완료 화면이 나타난 뒤 pH 보정 메인 화면으로 전환된다.
ex) 3 point로 보정을 보고 Out키를 눌러 보정을 마무리 한 경우.

(2) Manual(수동보정)

2-1) Cal 1 의 보정

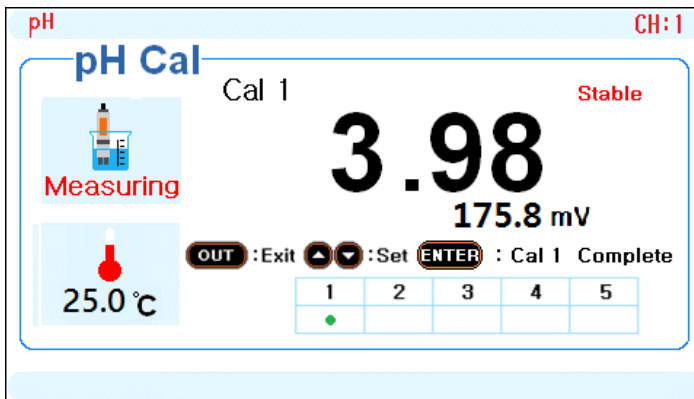


- 전극을 증류수로 세척하고 물기를 제거한 후 첫 번째 보정용액을 준비하여 전극을 담근다.
- 실측 값을 확인하며, 디스플레이 화면에 “Stable” 확인이 되면 화살표키로 원하는 값까지 조정 후 Enter 키로 보정값을 저장한다.

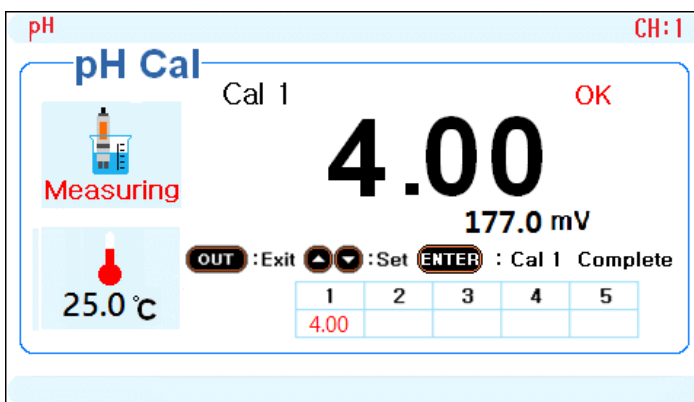


- 보정 값이 하단에 표시되며 Cal 1 보정이 완료된다. 그리고 Cal 2 로 자동 넘어간다.

2-2) Cal 2 의 보정

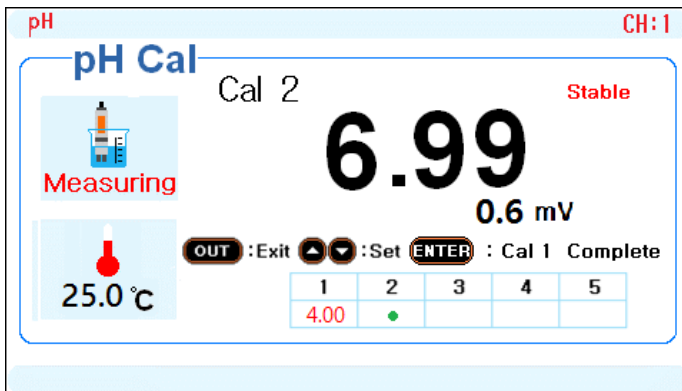


- 전극을 증류수로 세척 후 두 번째 보정용액에 넣어 보정을 시작한다.
- 실측 값이 안정되면 화살표키로 원하는 값까지 조정 후 Enter 키로 Cal 2 보정을 완료한다.

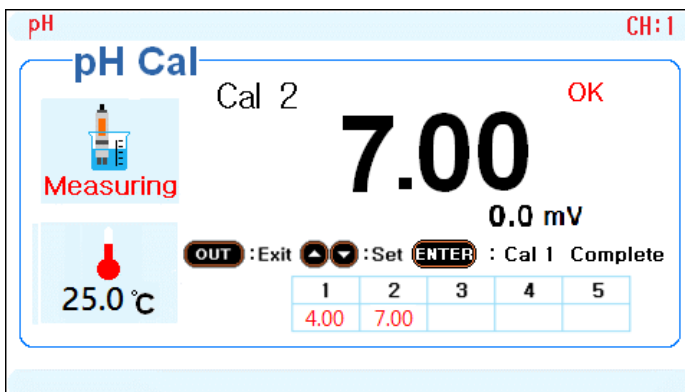

- 보정 값이 하단에 표시되며 Cal 2 보정이 완료된다. 그리고 Cal 3 로 자동 넘어간다.

2-3) Cal 3~5 의 보정

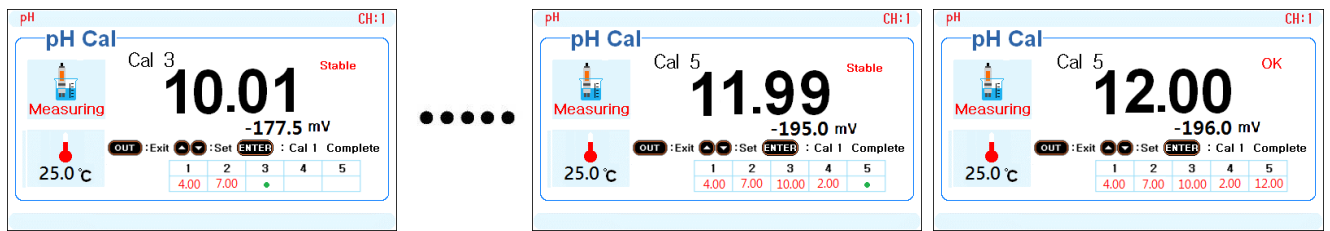


- Cal 3, Cal 4 그리고 Cal 5 의 보정 모두 동일한 방법으로 진행하며, 보정이 완료되면 **Memory/Out** 키를 눌러 마무리 한다.

★ 수동보정은 자동보정과는 달리 1 부터 5 까지 순서만 표시되고 Buffer 의 실측 값이 표시가 되는 것이 아니라 사용자가 설정한 Buffer 용액의 보정 값을 표시해 준다.

2. ORP

ORP 는 절대 ORP 와 상대 ORP 로 구분한다. ORP 의 보정은 절대 ORP 를 선택하여 보는 경우 의미가 있다.

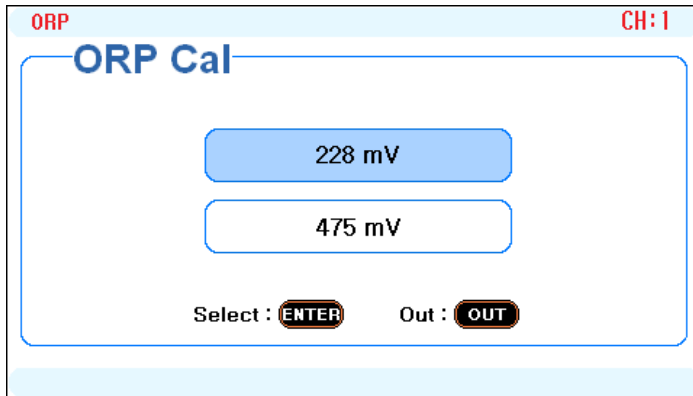


다음과 같은 순서로 보정 모드로 전환한다.

pH 화면 -> Mode -> ORP 화면-> Cal/Res -> 보정화면

ORP 보정은 2 가지 보정 용액 중 하나를 선택하여 1 point 보정으로 진행한다.

- 보정용액 : 228mV 또는 475mV

(1) 228mV 의 보정

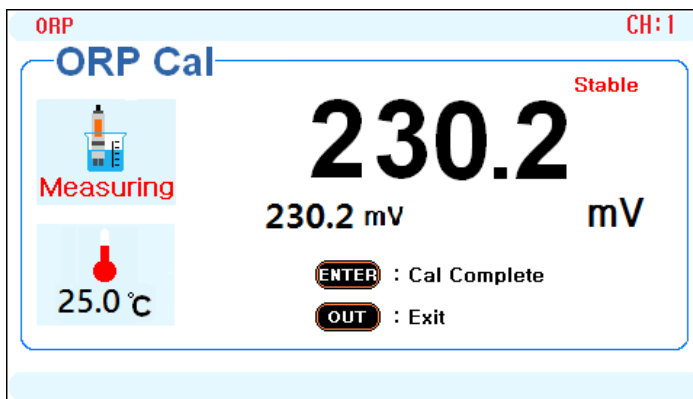


- 228mV 를 선택하여 **Enter** 키를 누른다.

- 별도의 키 동작 없이 보정을 시작하면 자동으로 Measuring 상태가 된다.

- Probe 을 증류수로 세척하고 물기를 제거한 후 보정용액을 준비하여 전극을 담근다.

- 실측 값을 확인하며 디스플레이 화면에 "Stable"이 나타나기를 기다린다.


[228 mV 용액으로 보정시]

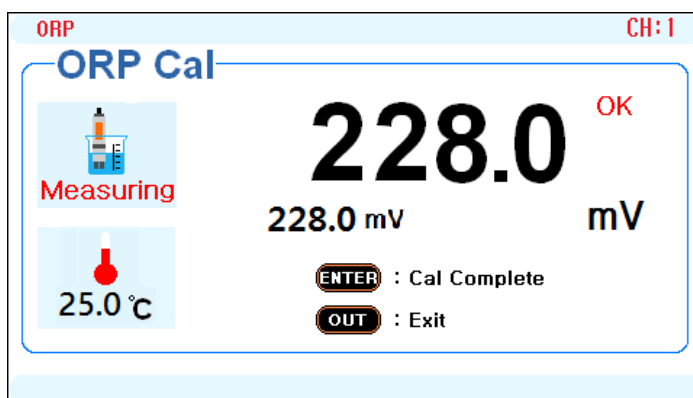

- **Enter** 키를 눌러 보정을 마무리 한다.


[228 mV 보정 완료 화면]

(2) 475mV 의 보정

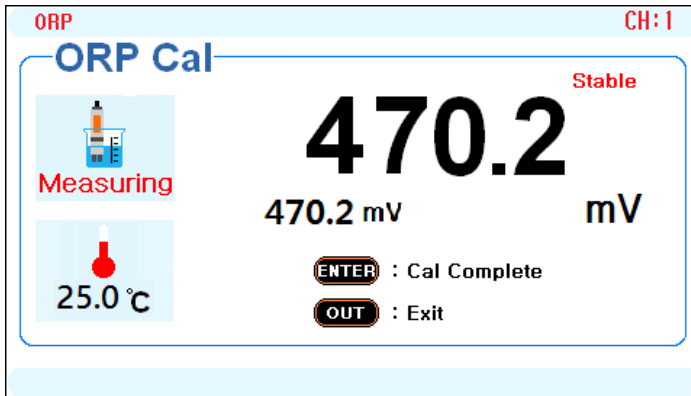

[475 mV 용액으로 보정시]

- 475mV 를 선택하여 **Enter** 키를 누른다.
- 별도의 키 동작 없이 보정을 시작하면 자동으로 Measuring 상태가 된다.
- Probe 을 증류수로 세척하고 물기를 제거한 후 보정용액을 준비하여 전극을 담근다.
- 실측 값을 확인하며 디스플레이 화면에 “Stable”이 나타나기를 기다린다.

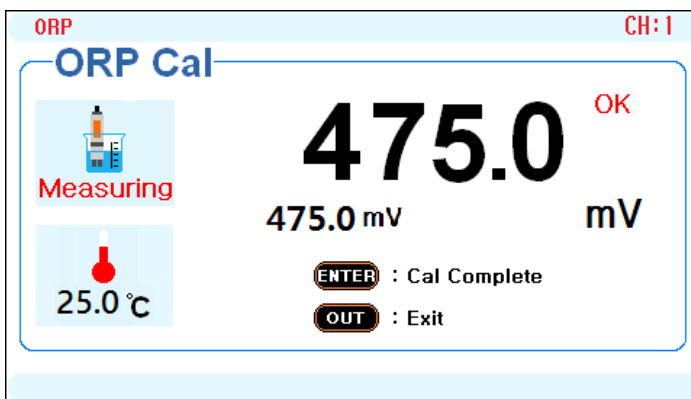

- **Enter** 키를 눌러 보정을 마무리 한다.

[475 mV 보정 완료 화면]

3. Ion

Ion CH:1

Ion Cal

0.1 mg/l	100 mg/l
1 mg/l	1,000 mg/l
10 mg/l	10,000 mg/l

Cal : **Cal** Select : **ENTER** Out : **OUT** **F⁻**

다음과 같은 순서로 보정 모드로 전환한다.

pH 화면 → Mode 2 번 → Ion 화면 → Cal/Res
 → Ion 용액 선택 화면 → Enter 선택 → Cal/Res
 → Ion 보정 화면

Ion CH:1

Ion Cal

Select 0.1 mg/l	100 mg/l
1 mg/l	1,000 mg/l
10 mg/l	10,000 mg/l

Cal : **Cal** Select : **ENTER** Out : **OUT** **F⁻**

- Ion의 보정은 보정 용액 중 최소 2 point, 최대 5 point 까지 선택하여 보정이 가능하며 **Enter** 키로 선택한다.
- 보정용액 : 0.1mg/l, 1 mg/l, 10 mg/l, 100 mg/l, 1,000 mg/l, 10,000 mg/l
 (10 배 수로 선택하여 보정 가능)

Setup (Ion Type)

NH ₃	NH ₄ ⁺	Br ⁻	Cd ⁺²
Ca ⁺²	CO ₂ /CO ₃ ⁻²	Cl ⁻	Cu ⁺²
CN ⁻	F⁻	BF ₄ ⁻	I ⁻
Pb ⁺²	NO ₃ ⁻	NO _x	ClO ₄ ⁻
K ⁺	Ag ⁺ /S ⁻²	Na ⁺	X ⁺ /X ⁻
WH	T-WH		

[Ion 종류 선택]

* Ion 보정은 22 가지 이온 종류 중 하나를 선택하여 진행 가능하다.


(Ion 종류 선택방법은 Setup 메뉴의 Ion Type 에서 확인한다.)

Ion CH:1

Ion Cal



-5.0
-113.0 mV mg/L



25.0 °C

0.1 1.0 * * *

ENTER : Complete **OUT** : Exit **F⁻**



- 별도의 키 동작 없이 보정을 시작하면 자동으로 Measuring 상태가 된다.

- 선택된 보정용액이 화면에 표시가 되며 **Enter** 키를 눌러 보정 값을 저장한다.

- 보정이 끝난 후, **Memory/Our** 키를 눌러 보정을 마무리 한다.

- 보정 완료 화면이 뜨고 다시 용액 선택 화면이 나오면 **Memory/Out** 로 빠져나온다.


제 5 장 Data-Log

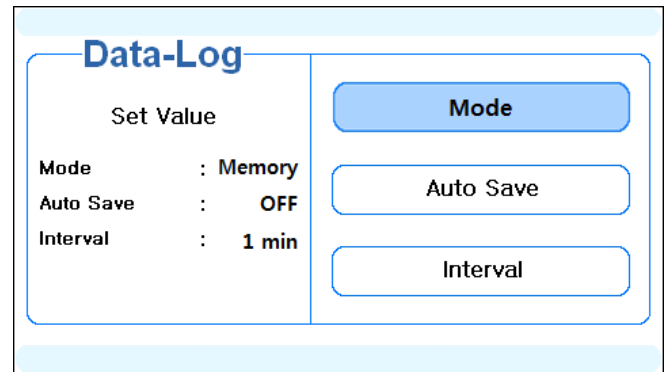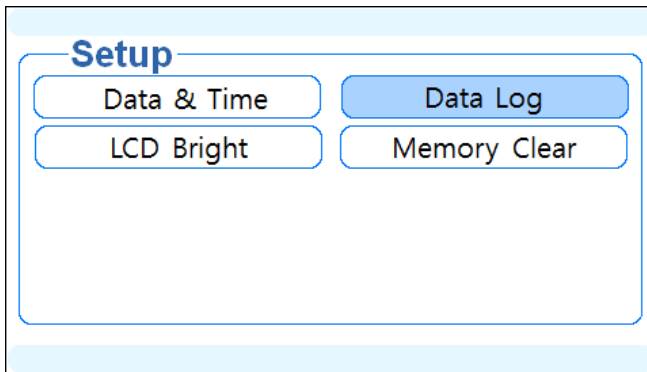

Data-Log 에 대한 설정을 진행한다. 단채널 Ready 화면 -> Setup -> Setup -> Data Log


(1) Mode

Mode 에서 Memory, RS-232C 또는 Printer 선택이 가능하다.

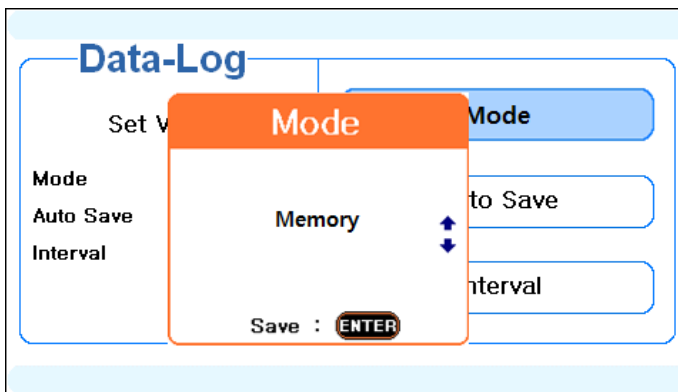


1-1) Memory

- 측정시, 기기 내부 저장소에 데이터 자동저장
- Memory 선택시 Auto Save 메뉴와 Interval 메뉴 설정 가능
- 측정중, Print 버튼을 누르면 선택한 데이터 프린터 출력 가능

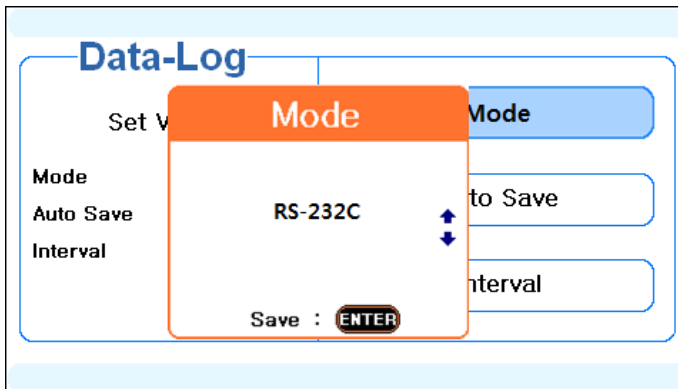

1-2) RS-232C

- 기기와 PC 를 연결하여 데이터를 PC 로 실시간 전송 (SMSD 전용프로그램 설치)
- RS-232C 선택시 Interval 메뉴만 설정 가능

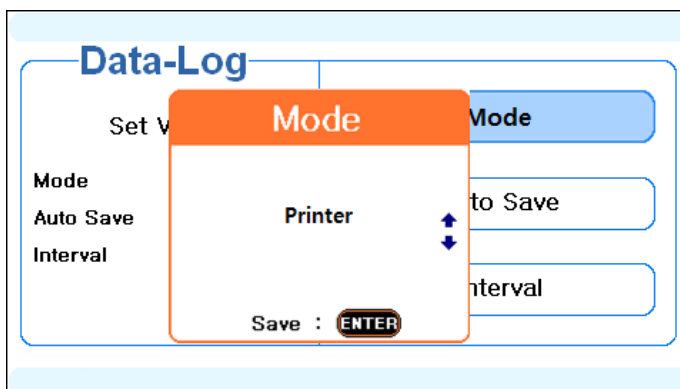


1-3) Printer

- 측정시, 자동으로 프린터 출력
 - Printer 선택시 Interval 메뉴만 설정 가능
- * 자동출력이 아닌 선택 데이터만 출력하는 경우에는 1-1)Memory 설명 참고

(2) Auto Save

측정 중 데이터 자동저장 기능으로 “Mode – Memory” 선택 후 Auto Save 설정이 가능하다.


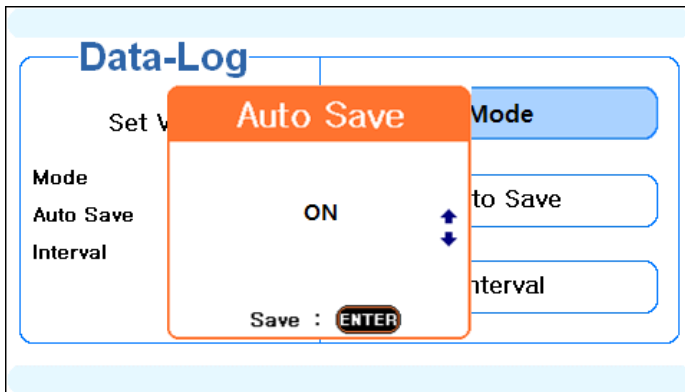


- “ON” 을 선택하여 데이터 자동 저장을 설정
- Auto Save 에서 ON 선택시, Interval 메뉴 설정 가능하며, 설정해 놓은 시간마다 측정값을 기기에 자동저장 한다.
- *“OFF” 선택시 Interval 메뉴 설정은 의미가 없으며, 사용자가 Memory 키를 누를 때 마다 값이 저장된다.



(3) Interval

Interval 설정시 원하는 단위를 Minute(분), Second(초) 중 선택하고, 숫자를 선택(0~200 까지 선택)하여 데이터 자동저장(Auto Save) 및 PC 통신출력(RS-232C) 간격을 조정한다.

(초 선택시 : 1~200 초 인터벌 설정, 분 선택시 : 1~120 분 인터벌 설정)

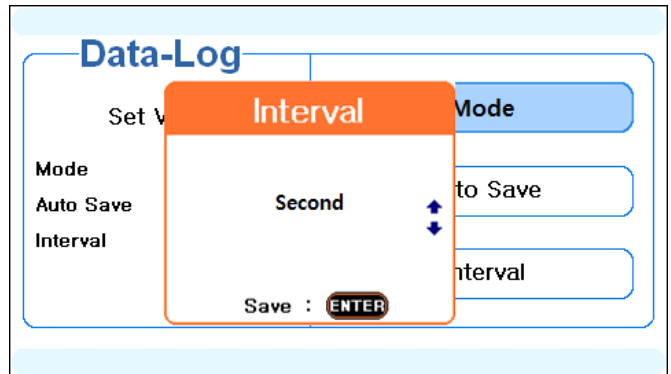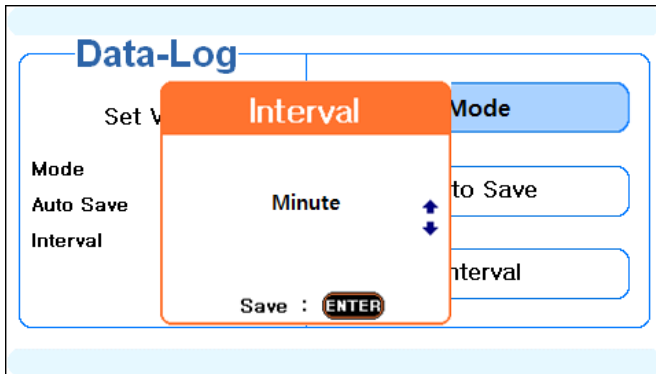

[분, 초 설정 화면]

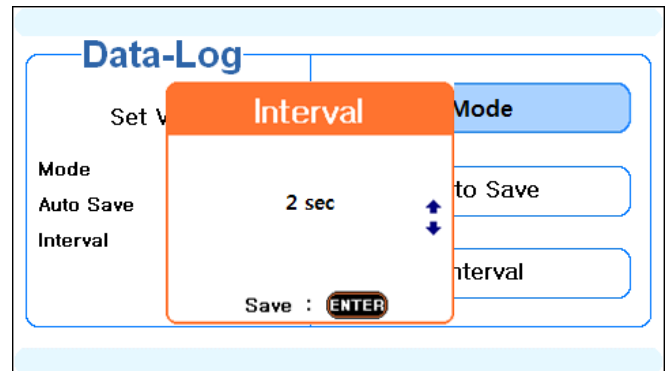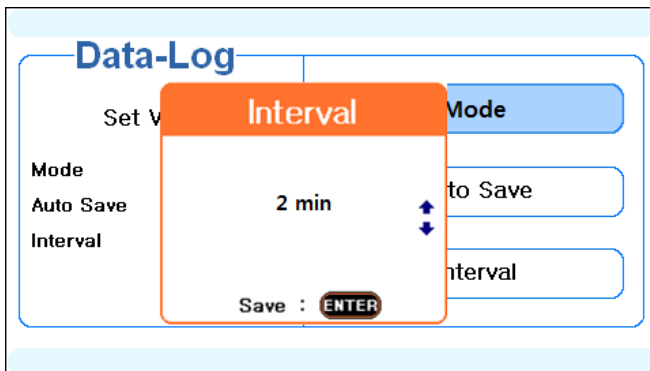

[숫자 설정 화면]


제 6 장 Save Data & Transfer

측정중 원하는 데이터 저장이 가능하며, 설정으로 자동 저장된 데이터 및 실시간 데이터는 PC에 연결하여 확인이 가능하다. 기본 설정은 Data-Log에서 진행한다.

- **Manual Save Data** : 측정중 수동 저장된 데이터 기기에서 확인
- **Auto Save Data Transfer** : 기기에 자동 저장된 데이터 PC에서 확인
- **Real-Time Data Transfer** : 실시간 측정 데이터 PC에서 확인

(1) Manual Save Data

측정중 원하는 데이터를 선택하여 수동으로 저장한 데이터는 기기에서 확인이 가능하다.

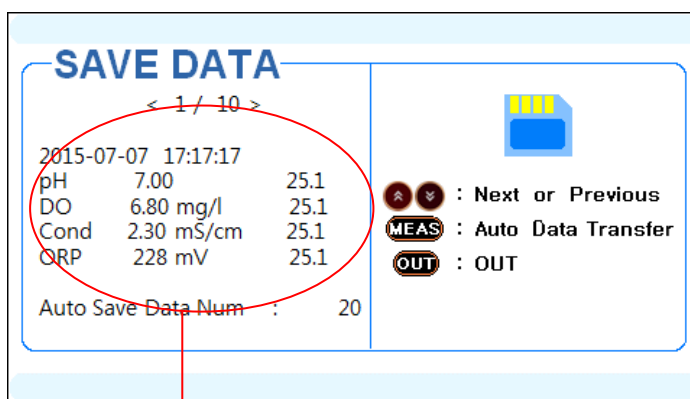

[저장된 데이터 화면]


* 기본 세팅 : Data-Log -> Mode -> Memory -> Enter -> Auto Save -> OFF -> Enter

- * 저장 : 측정중 **Memory** 키를 눌러 데이터 저장
- * 저장데이터 확인 : 대기상태에서 **Memory** 키를 눌러 화면 확인 (방향키로 이동하여 데이터 확인)

(2) Auto Save Data Transfer

기기에 자동 저장(Auto Save)된 데이터를 SMSD 프로그램을 이용하여 PC로 전송한다.

SMSD 프로그램 연결 -> MEAS 을 눌러 엑셀파일 및 프로그램에서 전송된 데이터를 확인한다.

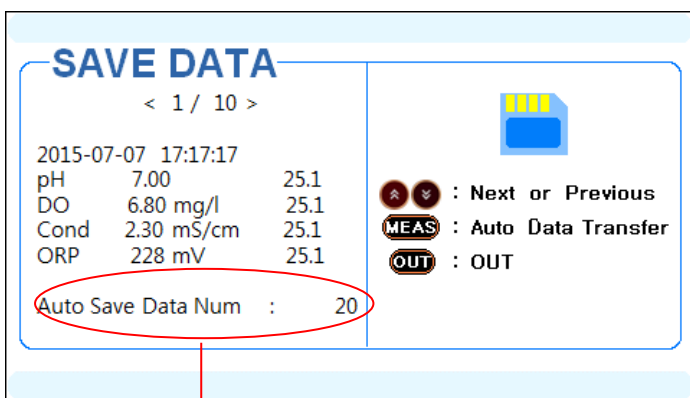


[자동저장(Auto Save)된 Data의 개수]

* 기본 세팅 : Data-Log -> Mode -> Memory -> Enter -> Auto Save -> ON -> Enter -> Interval -> 데이터 저장간격 설정

- * 저장 : 측정중 자동 저장
- * 저장데이터 확인 : 통신케이블을 이용하여 PC 연결하여 데이터 다운로드 후 확인
- * 전송 중지 : **Memory/Out** 키로 전송 중단

◆ PC 연결 하기

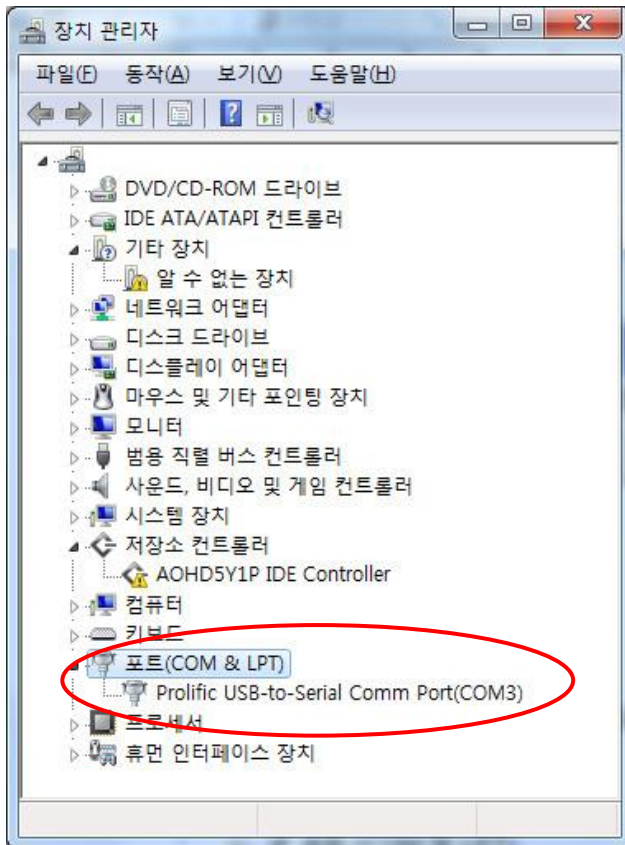


PC 연결 소프트웨어 SMSD 를 PC 에 설치한다.
기기와 PC 가 연결된 상태에서 다음과 같이 통신
설정 포트를 확인한다.

- 컴퓨터 -> 시스템속성 -> 장치관리자 ->
포트(COM & LPT)의 COM 포트 확인
- 예) 화면에서는 COM3 에 기기 연결됨

[PC COM 포트 확인 화면]


SMSD 프로그램을 실행하여 다음과 같이 설정한다.

- Model : Desk
- Port : COM3 (PC 에서 확인한 포트를 선택하면 됨)
- Baud Rate : 9600
- Open 버튼을 눌러 연결 완료

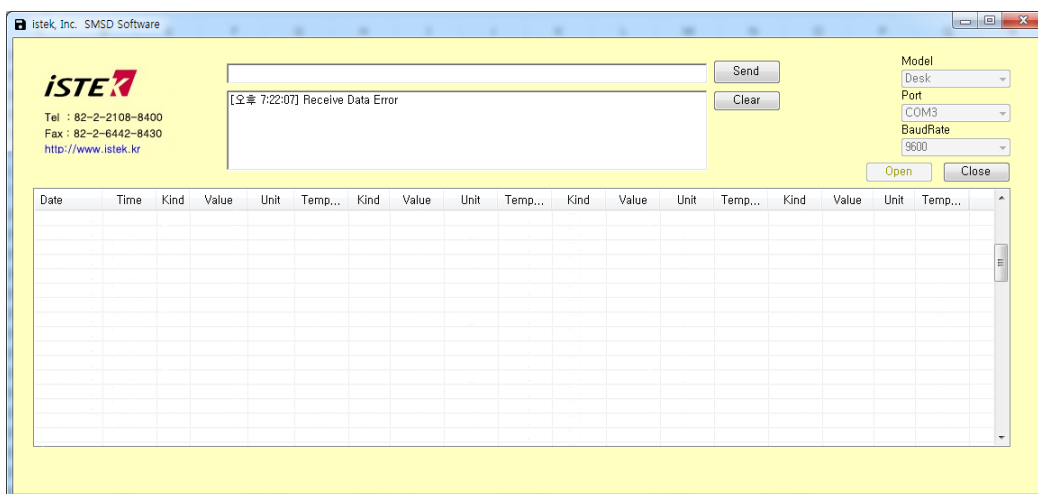


[SMSD 프로그램 화면]

기지에서 **Meas** 키를 눌러 자동 저장된 데이터를 PC로 전송한다.

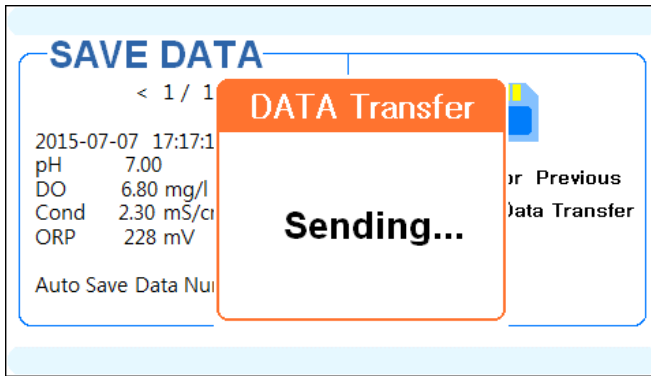


[Data 전송중 화면]

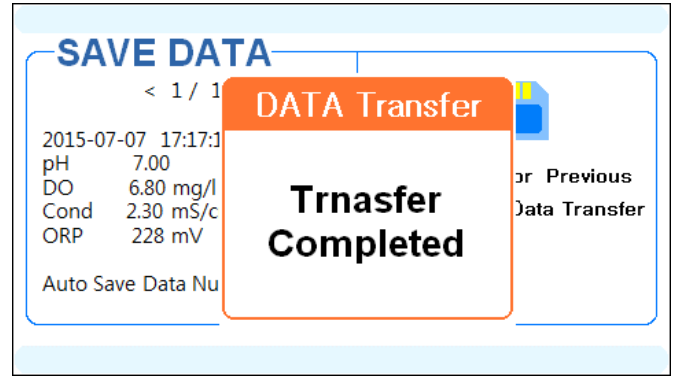

[Data 전송 완료 및 중지시 화면]

PC 상에 SMSD 프로그램과 엑셀파일로 데이터가 전송된다.

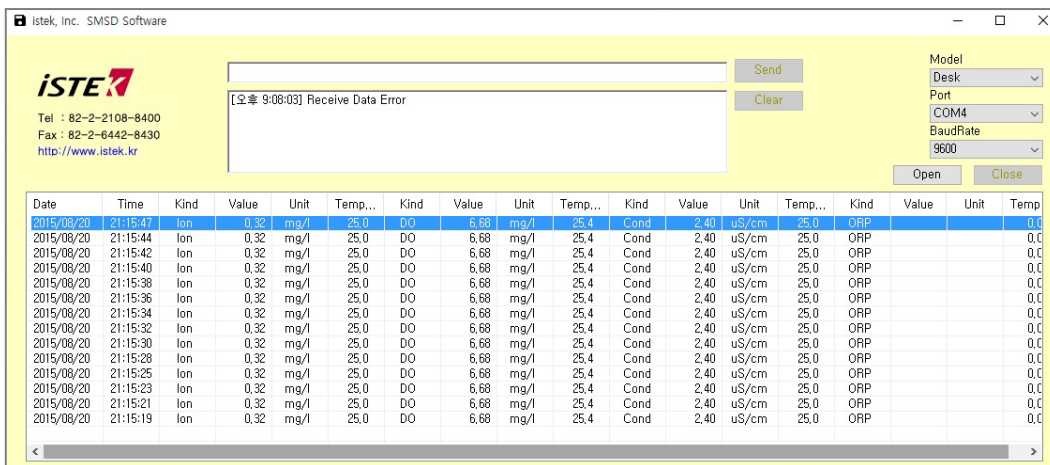

[데이터 전송된 SMSD 소프트웨어 화면]

2015-08-20															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2015-08-20	21:15:19	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
2	2015-08-20	21:15:21	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
3	2015-08-20	21:15:23	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
4	2015-08-20	21:15:25	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
5	2015-08-20	21:15:28	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
6	2015-08-20	21:15:30	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
7	2015-08-20	21:15:32	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
8	2015-08-20	21:15:34	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
9	2015-08-20	21:15:36	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
10	2015-08-20	21:15:38	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
11	2015-08-20	21:15:40	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
12	2015-08-20	21:15:42	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP
13	2015-08-20	21:15:44	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25.0	ORP

[데이터 전송된 엑셀 화면]

(3) Real-Time Data Transfer


현재 측정하고 있는 데이터를 실시간으로 SMSD 프로그램을 이용하여 PC 에서 실시간 확인한다.

기본 설정은 제 5 장 Data-Log 섹션을 참고한다.

* 기본 세팅 : Data-Log -> Mode -> Enter -> RS-232C -> Enter

Interval -> Enter -> Second or Minute 중 택 1 -> Enter -> 0~200 중 택 1 -> Enter

◆ PC 연결 하기

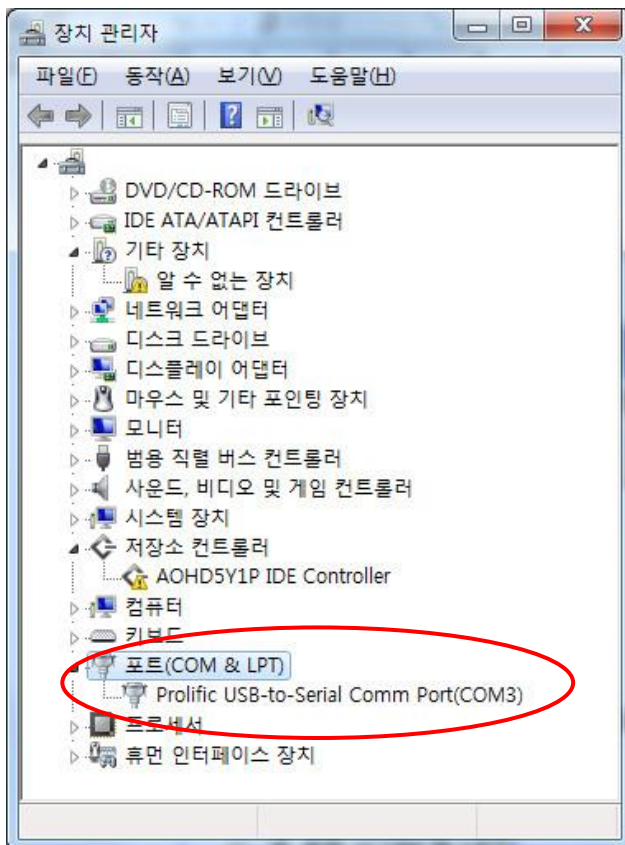

PC 연결 소프트웨어 SMSD 를 PC 에 설치한다.
기기와 PC 가 연결된 상태에서 다음과 같이 통신
설정 포트를 확인한다.


- 컴퓨터 -> 시스템속성 -> 장치관리자 ->
포트(COM & LPT)의 COM 포트 확인
- 예) 화면에서는 COM3 에 기기 연결됨

[PC COM 포트 확인 화면]

SMSD 프로그램을 실행하여 다음과 같이 설정한다.

- Model : Desk
- Port : COM3 (PC 에서 확인한 포트를 선택하면 됨)
- Baud Rate : 9600

Open 버튼을 눌러 연결 완료

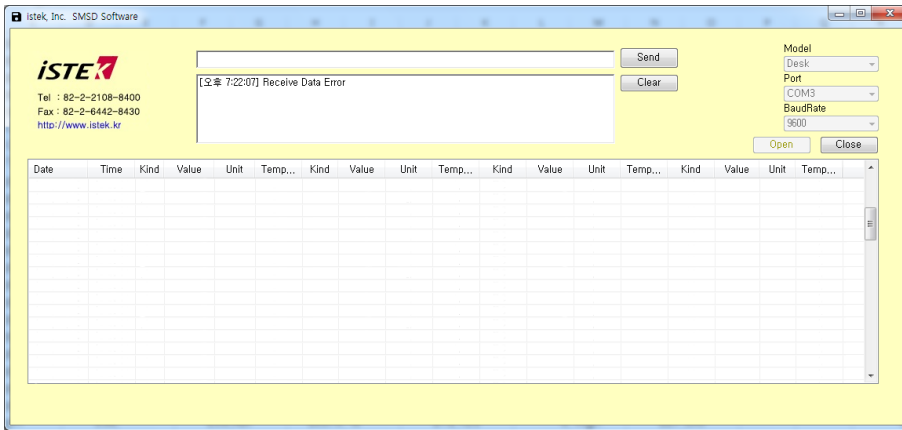

[SMSD 프로그램 화면]

Memory/Out 키를 눌러 측정 화면으로 전환 한 후, Meas 키를 눌러 데이터를 측정한다.

Date	Time	Kind	Value	Unit	Temp...	Kind	Value	Unit	Temp...	Kind	Value	Unit	Temp...	Kind	Value	Unit	Temp...
2015/08/20	21:15:47	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:44	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:42	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:40	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:38	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:36	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:34	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:32	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:30	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:28	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:25	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:23	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:21	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0
2015/08/20	21:15:19	Ion	0.32	mg/l	25.0	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.40	uS/cm	25.0	ORP			0.0

PC 상에 SMSD 프로그램과 엑셀파일로 데이터가 전송됨

[데이터 전송된 SMSD 소프트웨어 화면]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2015-08-20	21:15:19	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
2	2015-08-20	21:15:21	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
3	2015-08-20	21:15:23	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
4	2015-08-20	21:15:25	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
5	2015-08-20	21:15:28	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
6	2015-08-20	21:15:30	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
7	2015-08-20	21:15:32	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
8	2015-08-20	21:15:34	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
9	2015-08-20	21:15:36	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
10	2015-08-20	21:15:38	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
11	2015-08-20	21:15:40	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
12	2015-08-20	21:15:42	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP
13	2015-08-20	21:15:44	Ion	0.32	mg/l	25	DO	6.68	mg/l	25.4	Cond	2.4	uS/cm	25	ORP


[데이터 전송된 엑셀 화면]

제 7 장 Memory Clear

기기 Setup 화면에서 Memory Clear 를 선택하면 다음 화면이 나타난다.

Memory 와 ALL 메뉴 선택이 가능하며, 기능은 아래와 같다.

단채널 Ready 화면 -> Setup -> Setup -> Memory Clear

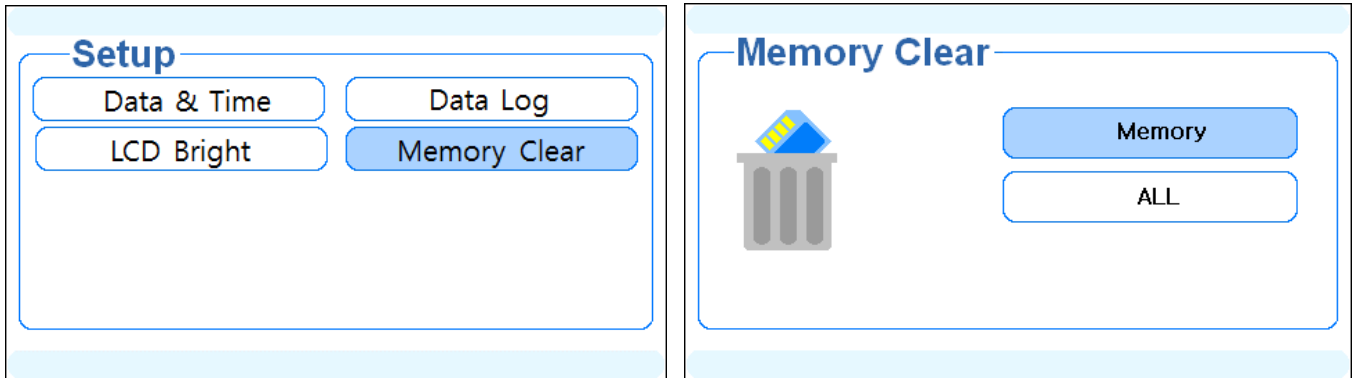


- **Memory** : 저장된 데이터 삭제

저장된 데이터의 개별 삭제는 불가

- **ALL** : 기기 초기화



저장된 데이터, 모든 항목 보정데이터, 설정 값 등 모든 저장된 값들은 삭제

(1) Memory Clear

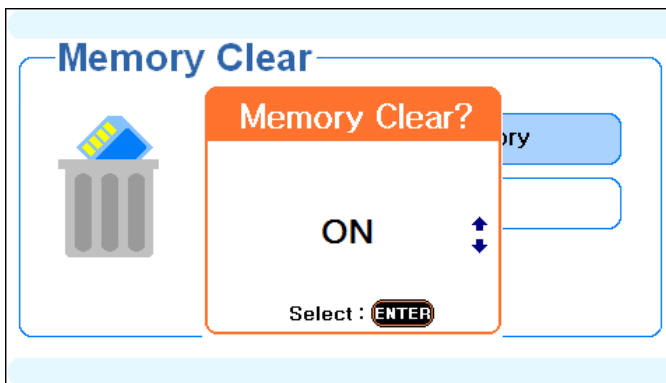


다음과 같은 순서로 저장된 데이터를 삭제한다.

Memory -> Enter -> ON -> Enter

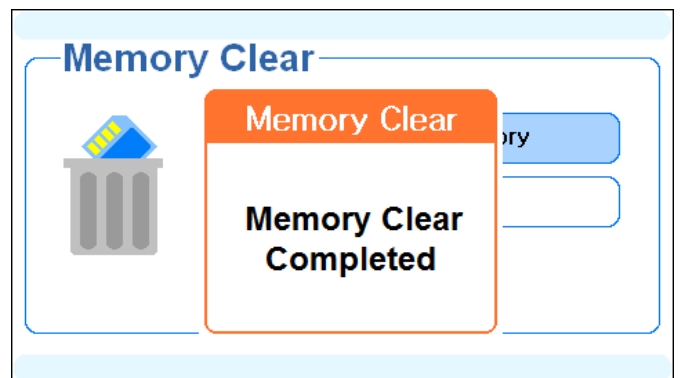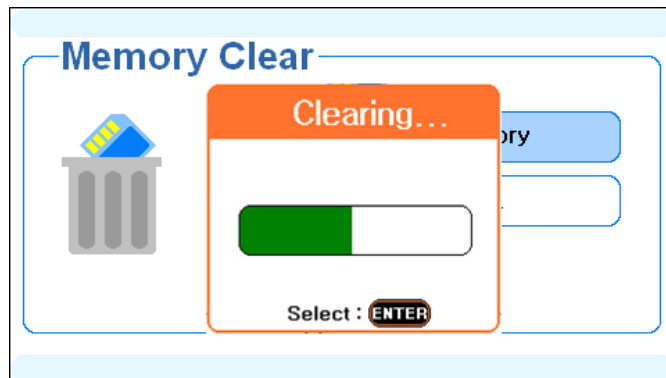


메모리가 삭제되면 “Memory Clear Completed” 화면이 나오고 저장된 모든 데이터가 삭제된다.

(2) ALL Clear

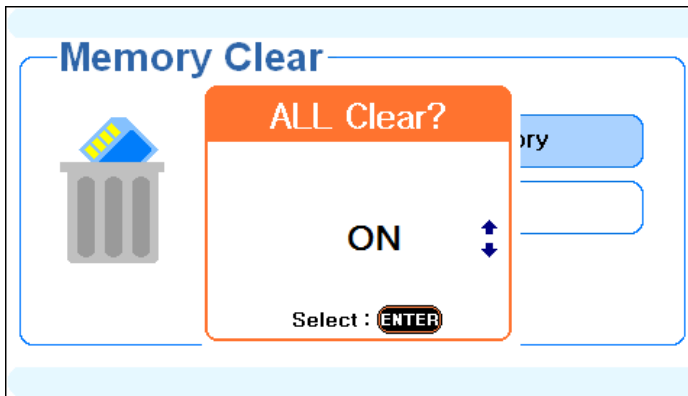

기기에 저장 및 설정된 모든 값을 지우기 위해서 ALL 을 선택한 후, 다음과 같은 순서로 모든 값을 삭제한다.

ALL -> Enter -> ON -> Enter

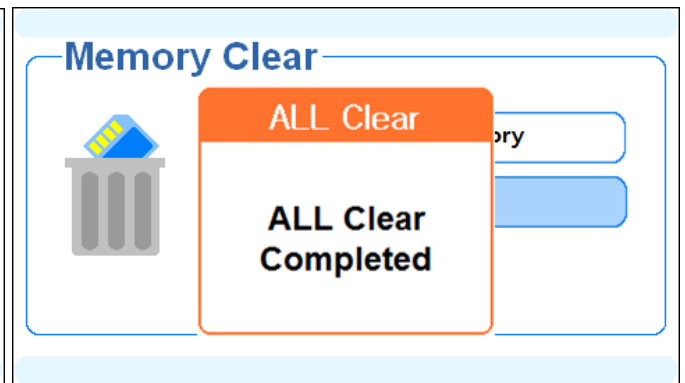

데이터가 삭제되면 “ALL Clear Completed” 화면이 나오고 저장된 모든 데이터가 삭제된다.

제 8 장 Troubleshooting & Error Description

* Error 의 원인과 해결법을 읽고 해결이 되지 않을 경우에는 (주)이스텍으로 연락 바랍니다.
사용자 과실에 의해 발생한 오류에 대해서는 당사는 책임지지 않습니다.

발생문제	가능한 요인	해결방법
화면에 문자가 표시되지 않는다.	Meter 의 power 가 꺼져 있음. 키패드 문제.	전원 버튼을 다시 누른다. 이스텍에서 제공한 아답터인지 확인한다. (12V 2.5A 용량) 이스텍에 A/S 를 보내 정확한 원인을 파악한다.
보정 도중 측정값을 입력하기 위해 Enter 키를 눌렀을 때 반응이 없거나, Error 가 발생한다.	동일한 용액으로 이중 보정을 진행함. Buffer 용액을 기준으로 실측값이 $\pm 1\text{pH}$ 이상 벗어남	버퍼 용액을 중복하여 측정하는 것은 아닌지 확인한다. 다른 농도의 Buffer 를 사용하여 보정을 다시 진행한다. Buffer 용액의 오염이 의심되는 경우에는 새로운 용액으로 다시 준비한다. 전극에 이상이 있거나 수명이 다했는지 확인한다. 수동보정으로 보정을 진행한다.
측정 중 Error 가 발생한다.	측정범위를 벗어남.	전극이 올바르게 연결 되어 있는지 확인한다. 보정을 다시 진행하여 측정한다.
전극의 응답시간이 느리거나 안정된 측정값 출력이 안될 때	전극이 오염되어있는 경우. 전극이 깨져있는 경우. 전극의 수명이 다한 경우	전극을 깨끗이 세척한다. 리필이 가능한 전극의 경우, Filling 용액을 교체한다. 새로운 전극으로 교체한다.
원인을 알지 못하는 경우	기기적인 오류발생	“Memory Clear”를 진행하고, 다시 보정을 진행하여 측정한다.

제 9 장 Specifications & Ordering Information

※ 자세한 사항은 catalog 를 참조하거나 (주)이스텍(Tel)02-2108-8400)으로 연락 바랍니다.

1. Specifications

측정 항목		실험실용 멀티 측정기 K Series Multi meter									
			K9000-M (4 CH)	K9000-M(P) (1 CH)	K9000-M(PP) (2 CH)	K9000-M(PPP) (3 CH)	K9000-M(D) (1 CH)	K4000-EC (1 CH)	K9000-M(PC) (2 CH)	K9000-M(PD) (2 CH)	K9000-M(PDC) (3 CH)
pH	범위	-2.000 ~ 19.999	o	o	o	o			o	o	o
	분해능	0.001 / 0.01 / 0.1	o	o	o	o			o	o	o
	정확도	±0.002 pH	o	o	o	o			o	o	o
	Buffer 자동인식	2 / 4 / 7 / 10 / 12	o	o	o	o			o	o	o
ORP (Rel-mV)	범위	±1999.9 mV	o	o	o	o			o	o	o
	분해능	0.1	o	o	o	o			o	o	o
	정확도	±0.1 mV	o	o	o	o			o	o	o
Ion	범위	0.0001 ~ 19,999	o	o	o	o			o	o	o
	분해능	0.1	o	o	o	o			o	o	o
	정확도	±5 %	o	o	o	o			o	o	o
DO	범위	0.00 ~ 19.99 mg/l	o				o			o	o
	분해능	0.001 / 0.01 / 0.1	o				o			o	o
	정확도	±0.5 mg/l	o				o			o	o
O ₂	범위	0.0 ~ 60.0	o				o			o	o
	분해능	0.1	o				o			o	o
	정확도	±0.5 %	o				o			o	o
Air	범위	0.0 ~ 199.9	o				o			o	o
	분해능	0.1	o				o			o	o
	정확도	±1 digit	o				o			o	o
전도도	범위	0.0 ~ 199,999 uS/cm	o					o	o		o
	분해능	0.01 / 0.1	o					o	o		o
	정확도	±0.5 %	o					o	o		o
TDS	범위	0 ~ 1999 mg/l	o					o	o		o
	분해능	1	o					o	o		o
	정확도	±2 %	o					o	o		o
염도	범위	0 ~ 80 ppt	o					o	o		o
	분해능	0.001 / 0.01 / 0.1	o					o	o		o
	정확도	±0.5 %	o					o	o		o
저항	범위	5Ω x cm ~ 100 MΩ x cm	o					o	o		o
온도	범위	-10 ~ 110 °C	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	분해능	0.1	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	정확도	±0.4 °C	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	온도보상	자동 온도보상	o	o	o	o	o	o	o	o	o
종류		PT100 / 1000	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		실험실용 멀티 측정기 K Series Multi meter									
화면표시		4.3" TFT Color LCD									
온도보상		Auto									
Data-Log		Auto : 100,000 points / Manual : 500 points / SMSD연결시 무한대									
입 력		BNC, PJ362, DIN4Pin									
출 력		마이크로 5Pin, RS-232C									
소프트웨어		SMSD PC 전용 프로그램									
프린터 (옵션)		외장형 프린터									
크기/무게		200(L) x 260(W) x 90(H) / 950g									
전 원		AC/DC 12V3.0A Power Adapter									

2. Ordering Information

A. 기본 구성품

- * 기기 본체 K9000-M(P)
- * 각 구성품
- * AC/DC 전원 아답터 12V 2.5A
- * 스탠드 (Luxury Third-arm Stand)
- * SMSD 소프트웨어 (PC 연결용)
- * 데이터 전송 cable
- * 사용자 설명서

B. 항목 별 구성품

pH/ORP/Ion 항목 - pH

- * pH Electrode
- * ATC probe (PT100)
- * Buffer pH 4,7,10 set (125ml)
- * pH Storage Solution (125ml)

pH/ORP/Ion 항목 - ORP

- * ORP Electrode
- * ATC probe (PT100)
- * ORP Standard Solution 228mV (125ml)
- * ORP Storage Solution (125ml)

pH/ORP/Ion 항목 - Ion

- * Ion Electrode (22 개 항목 중 선택)
- * ATC probe (PT100)
- * Ion Standard Solution 100/1000 ppm (475ml)
- * Ion Filling Solution (125ml)
- * Ion ISA (Ion Selective Adjustor) Solution 125ml
- * Ion 전극 매뉴얼


(** Ion 종류에 따라 제공되는 항목 및 용량에 변경이 있을 수 있음)

C 추가 구성품


- * Thermal Printer (외장형 프린터)
- * Buffer pH 4,7,10 set (475ml)
- * Storage Solution (475ml) – pH/ORP 에 해당
- * ORP Standard Solution 228mV or 475mV (475ml))
- * RS-232C to USB 통신 cable

3. 순서도

(1) 기기 전체 순서도

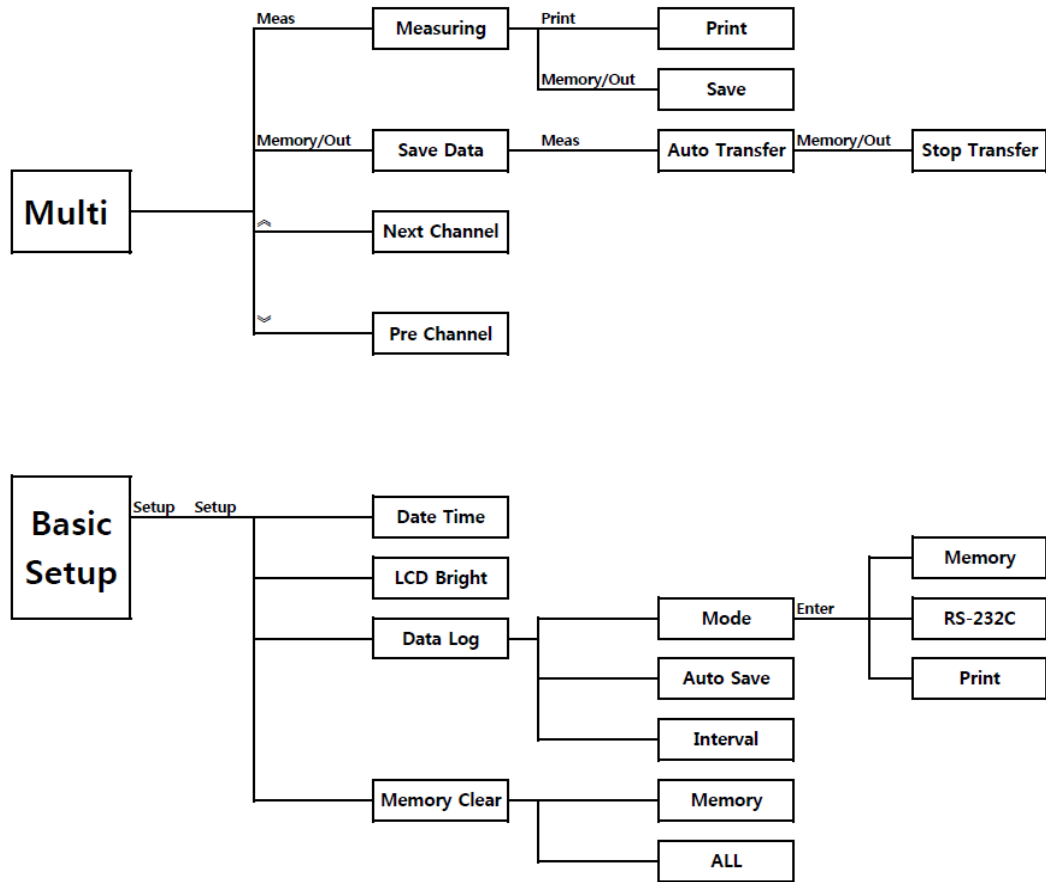

(2) pH/ORP/Ion 순서도

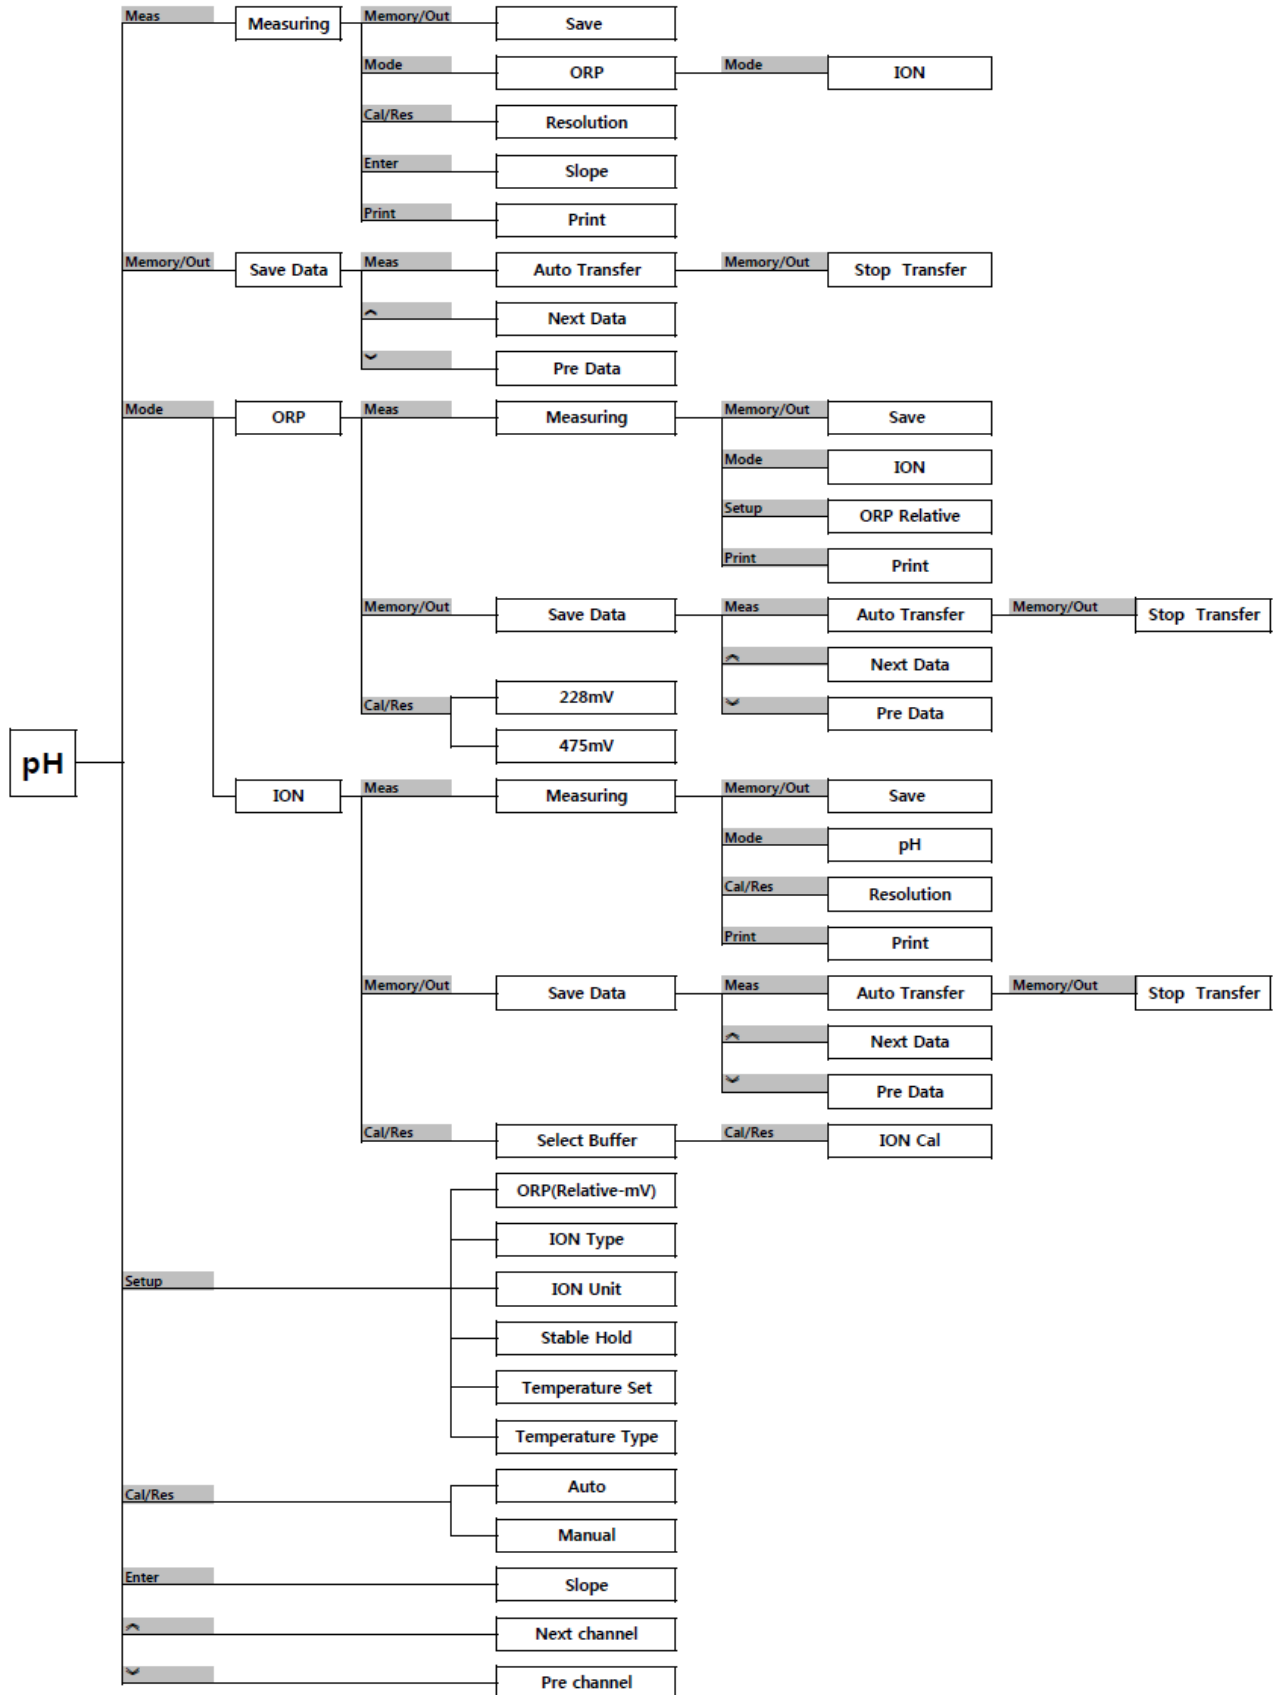

istek, Inc.

Room 1011,272, Digital-ro (Hanshin IT-Tower), Guro-gu, Seoul, Korea

Tel : +82-2-2108-8400

Fax : +82-2-6442-8430

Homepage : <http://www.istek.co.co.kr>

E-mail : istek@istek.co.co.kr

(주)이스텍

주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 272, 1011 호 (구로동, 한신 IT 타워)

대표전화 : 02-2108-8400

팩 스 : 02-6442-8430

홈페이지 : <http://www.istek.co.co.kr>

E-mail : istek@istek.co.co.kr

맑은 누리 가꿈이 이스텍

